

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL: NÚM. LA-908047994-T41-2015; RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE CLINICAS DENTALES SOLICITADO POR LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

En la ciudad de Chihuahua, Chih., siendo las 11:00 horas, del día 10 de Noviembre del 2015, en la Sala de Juntas de Adquisiciones, ubicada en calle Séptima, número 1210, Segundo Piso, Col. Centro; se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a la Convocatoria de la licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 33 y 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como en lo establecido en la Convocatoria de la licitación.


Este acto fue presidido por el Secretario del Comité de Adquisiciones, el C. L.A.E. Alberto Farres Chávez, delegado por el Presidente del Comité de Adquisiciones, designado por la convocante la Universidad Autónoma de Chihuahua, quien al inicio de esta junta, comunicó a los asistentes de conformidad con el artículo 33 Bis de la Ley, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la Convocatoria, de las personas que hayan presentado el Escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación, de forma presencial o a través de Compranet, por sí o en representación de un tercero, y cuyas preguntas se hayan recibido con 24 horas de anticipación a este acto, caso contrario, se les permitirá su asistencia sin poder formular preguntas.

El Secretario del Comité de Adquisiciones, fue asistido por el representante del Área Usuaría de la Facultad de Odontología, el cual solventó las preguntas de carácter técnico y el representante del Área Contratante del Departamento de Adquisiciones, el cual solventó las preguntas de carácter administrativo, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta.

El Secretario del Comité de Adquisiciones, dio inicio al mismo señalando que se recibieron en tiempo y forma de conformidad al artículo 33 Bis de la Ley, las solicitudes de aclaración a la Convocatoria y el Escrito de interés en participar, tanto en el domicilio de la Convocante como en Compranet, de las siguientes personas:

No.	Nombre, Razón o Denominación Social	Forma de Presentación	No. de preguntas	No. de hojas
1	ADESA DENTAL S.A. DE C.V.	Correo electrónico	5	1
2	PROMEDENTAL S.A. DE C.V.	Correo electrónico	13	3
3	COMERCIALIZADORA JASS DE COMPRESORES S.A. DE C.V.	Correo electrónico	1	2
4	IVG COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	Correo electrónico	6	2
5	UNIVERSAL SUPPLIERS DE MEXICO S.A. DE C.V.	Correo electrónico	2	1
6	PROMOVAGO	Correo electrónico	2	1

[Handwritten signatures and stamps]
FARM
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL

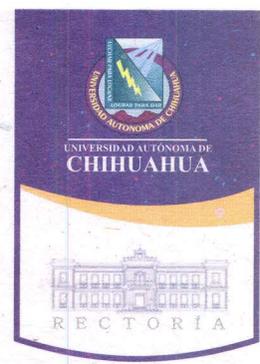

7	SAPLAI MEDICAL S.A. DE C.V.	Correo electrónico	1	1
---	-----------------------------	--------------------	---	---

- a) Se hace constar que las Empresas "TOLETEK MEXICO S.A. DE C.V." presentaron Escrito de interés en participar en tiempo y forma mas no presento preguntas.

Acto seguido, se procedió a la lectura de las solicitudes de aclaración a la Convocatoria presentadas en tiempo y forma por los interesados, así como la respuesta otorgada por la Convocante (cuando aplique), como se indica a continuación:

ADESA DENTAL S.A. DE C.V.

1. Nos gustaría que se autorice el pago de anticipo del 50% como mínimo en caso de adjudicación.

Se acepta la entrega de anticipo del 50%. Siempre y cuando sea entregada la fianza del anticipo.

2. La venta si se puede quedar en dólares y pagarse en pesos al tipo de cambio del día de pago.

No es posible que coticen en dólares, el monto de la propuesta económica tendrá que ser en pesos mexicanos.

3. El nombre del Director de la Facultad de Odontología ya no es el Dr. Gustavo Alatorre, viene otro nombre quien recibe el equipo como director.


Hubo un error en el apartado XXIII.- Pago, donde se menciona el nombre de otro director, favor de hacer caso omiso a ese nombre ya que el Director de la Facultad de Odontología es el Dr. Gustavo Alatorre Vallarino.

4. En la propuesta de equipos no se especifica marca.

Es correcto no se menciona marca ya que debe cumplir con las especificaciones técnicas mínimas solicitadas, no importando la marca.

5. Extender la fecha de entrega de 4 a 8 semanas, dado que dependiendo el equipo en tema de marca, el color se tiene que solicitar directo a fábrica y producir en específico.

Se acepta la fecha de entrega de 8 semanas contados a partir de la notificación del fallo respectivo.

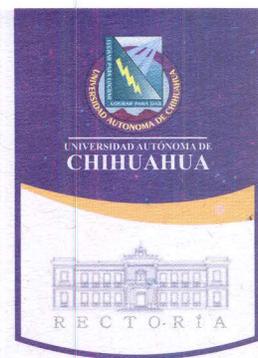

PROMEDENTAL S.A. DE C.V.

1. Referencia 9.10.

Se pide a la convocante, favor de aclarar si para dar cumplimiento a lo solicitado en este punto bastara con presentar carta de compromiso para servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, conteniendo la información del centro de atención, con los contactos, teléfonos, horarios y tiempos de respuesta, para estos servicios de mantenimiento. Debido a que el domicilio fiscal de mi representada se encuentra en la Cd de México, y ahí se encuentra también nuestro centro de servicio el cual tiene la capacidad de atención a nivel nacional.

Es correcto favor de incluir dicha carta con el domicilio de su empresa no importando que no sea en la ciudad de Chihuahua, se deberán incluir todos los datos solicitados.

2. Referencia VIII. Integración del sobre que contiene la proposición.

A) Proposición técnica.

Se recomienda a la convocante, que para dar mayor veracidad al procedimiento se solicite carta de apoyo del fabricante y/o del distribuidor autorizado en el país, de los bienes ofertados.

Se acepta carta del fabricante o de distribuidor autorizado.

3. Referencia VIII. Integración del sobre que contiene la proposición.


A) Proposición técnica.

Se recomienda a la convocante, que para dar mayor certeza jurídica y normativa, se solicite a los licitantes, el registro sanitario, certificados de buenas prácticas de fabricación, emitido por la COFEPRIS, ISO 9001-2008 y/o, ISO 13485, CE y/o FDA o TUV, según corresponda para bienes nacionales o internacionales.

Todo esto para evitar la adquisición de productos de dudosa calidad, como los de países tales como China, Pakistán, Corea, Malasia y Taiwán, que ponen en riesgo la integridad del paciente.

Cabe mencionar que a la fecha, no existen equipos nacionales que cumplan con las normas mínimas de calidad y legislación sanitaria.

Se acepta la propuesta de presentar los registros y certificaciones que los equipos ofertados contengan. Tenemos entendido que si existen equipos de fabricación nacional que cumplen con las normas mínimas y las

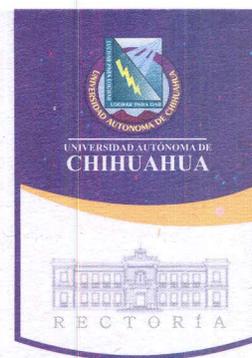

especificaciones técnicas solicitadas. Mas sin embargo el no presentar dichos requisitos, no incumple con lo solicitado y no es motivo para desechar propuesta alguna.

4. Referencia VIII. Integración del sobre que contiene la proposición.

A) Proposición Técnica.

Favor de especificar el tiempo de garantía de bienes que requiere la convocante. Considerando viable un periodo de 12 meses.

Se solicita que el tiempo de garantía de los bienes sea de 24 meses.

5. Referencia VIII. Integración del sobre que contiene la proposición.

A) Proposición técnica.

Se solicita a la convocante aclare de que en caso que los bienes ofertados requieran instalación y puesta en marcha, si las instalaciones de la convocante ya cuentan con adecuaciones eléctricas, aire e hidrosanitarias en los lugares de destino final.

Los equipos deberán ser instalados y puestos en marcha en las instalaciones de la facultad, las cuales ya cuentan con todas las adecuaciones para lo mismo.

6. Referencia VIII. Integración del sobre que contiene la proposición.

A) Proposición técnica.

En caso de que su respuesta a la pregunta anterior sea negativa, favor de indicar si bastara en caso de ser adjudicado, que entreguemos la guía mecánica correspondiente a los equipos que necesiten instalación, para que la convocante adecue las áreas de destino final, ya que nuestro servicio de instalación y puesta en marcha no comprende obras civiles en las unidades clínicas.


Ya fue respondida.

7. Referencia Anexo Uno – especificaciones técnicas de los bienes partida 1. Favor de aclarar si se podrá ofertar con escupidera de porcelana. Ya que esta característica no afecta la operación y procesos odontológicos ni la integridad del paciente.

Si se acepta.

[Handwritten signatures and initials]



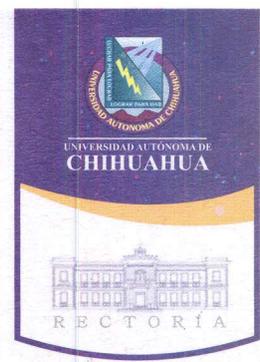

8. Referencia Anexo Uno – especificaciones técnicas de los bienes. Partida 1. Favor de aclarar si se podrá ofertar control de pie y touch pad.

Si se acepta.

9. Referencia Anexo Uno – Especificaciones técnicas de los bienes. Partida 1. Favor de aclarar si se refiere a touch pad, igual a digital.

Es correcto.

10. Referencia Anexo uno – especificaciones técnicas de los bienes. Partida 1. Favor de aclarar si se podrá ofertar con accionamiento de lámpara, escupidera, negatoscopio, llenado de vaso y movimientos, digitales sin perillas, lo cual es una tecnología superior.

Si se acepta.

11. Referencia Anexo uno – especificaciones técnicas de los bienes. Partida 1. Favor de aclarar si el equipo se necesita con calentador de agua.

No se requiere.

12. Referencia Anexo uno – especificaciones técnicas de los bienes. Partida 1. Favor de aclarar si el equipo se necesita con memorias programables para los movimientos del sillón.

Si se acepta.

13. Referencia Anexo uno – especificaciones técnicas de los bienes. Partida 1. Favor de aclarar si el equipo se necesita con 3 entradas para piezas de mano y una para jeringa triple.

Se requiere con dos entradas para piezas de mano y una para jeringa triple.



COMERCIALIZADORA JASS DE COMPRESORES S.A. DE C.V.

1. Punto 10 del aparatado VIII. Punto 1. Integración del sobre que contiene la proposición: Inciso A proposición técnica.

Carta que manifieste que la empresa licitante cuenta con un centro de servicio y atención a clientes en la ciudad de Chihuahua, Chih., indicando los datos de las oficinas y atención a clientes de la empresa; así como indicando dirección, horario, teléfono, correo electrónico, y en caso de tener numero 01-800, también incluirlo. (Anexo "I" incluido en estas bases). En caso de que el convenio de pago directo sea con un proveedor externo; también incluir los datos del mismo.

Pregunta: tratandose de una licitación publica internacional bajo la cobertura de tratados; es valido y obligatorio tener el centro de servicio y atención a clientes en la ciudad? Si este fuera el caso, se estaría coartando la libre participación de posibles proveedores y/o fabricantes que cuentan con el respaldo y la calidad de los bienes a suministrar puesto que se trata de equipos nuevos que están presentes en diversas entidades tanto publicas como privadas en diversas ciudades del país, siendo garantizadas por periodos mayores al solicitado en este caso por la universidad. Favor de aclarar si es posible participar, ya que nuestro único interés es la partida 3.

Ya fue respondida.

IVG COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.


1. De acuerdo al punto VIII. No. 2 Inciso "C" se entiende se recibirán propuestas de equipos que cumplan con las reglas de adquisición de acuerdo al tratado de libre comercio.
Es correcta esta apreciación?

Ya fue respondida.

2. Solicitamos a la convocante que para los equipos de importación podrían ampliar el tiempo de entrega a 60 días contados a partir del fallo.
Se acepta la propuesta?

Ya fue respondida.

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'RV', 'FAAD', and 'P']

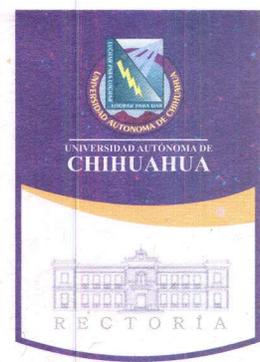

3. Solicitamos a la convocante si nos podrían informar si la partida 1 Unidades dentales se instalaran en una clínica nueva o donde ya existen unidades dentales.

25 de las unidades dentales serán instaladas en una clínica nueva y 19 serán instaladas en una clínica remodelada, ambas ya cuentan con las adecuaciones para su instalación y puesta en marcha.

4. Sugerimos a la convocante que los equipos de importación se anexasen registros de calidad como CE, ISO, FDA y certificados de origen de acuerdo a las normas internacionales siendo esto requisito para todos los participantes.

Se acepta la propuesta?

Ya fue respondida.

5. Sugerimos a la convocante solicite carta directa del fabricante así como se pida en original y notariada y/o apostillada en original y que sea un requisito para todos los participantes.

Se acepta la propuesta?

Ya fue respondida.

6. Las mesas de trabajo, partida 2, se puede ofertar de tubo cuadrado en vez de redondo, con cuadrado queda mejor.


Se acepta la propuesta?

Si se acepta.

7. Del banco el pistón que solicitan en la partida 7, la base metálica es de acero comercial tubular metálico cromado o de hierro fundido cromado o de aluminio fundido, ya que nuestra apreciación identifica como tubular cromada.

Es correcta nuestra apreciación?

Puede ser en acero cromado, hierro fundido cromado o de aluminio fundido.

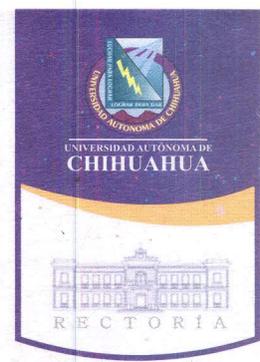

UNIVERSAL SUPPLIERS DE MEXICO S.A. DE C.V.

1. Partida 2: solicitan mesas de trabajo: fabricadas en acero inoxidable Haysi 430 de 20" X 20" X 32"H, cuenta con 2 cubiertas en lamina cal. 20 de 1.25" de lado, patas angulo de acero inoxidable cal. 14, la cubierta superior y 2 entrepaños en forma de charola con bordes de 2" por 3 lados, ruedas sanitarias de 2".

Podemos ofertar las mesas fabricadas en Acero Inoxidable tipo AISI 304 2B, que es de mejor calidad, así mismo que nos proporcionen imágenes de esta mesa.

Si se acepta su propuesta. Se enviara imagen por correo.

2. Partida 9: Mobiliario con las siguientes especificaciones: a base de estructura metálica de PTC y lamina para almacenar 2 botes de residuos peligrosos para ruta de RPBI de las clínicas dentales, incluye 2 puertas metálicas con pasador y portacandados, bisagras, elaboración de boquete para conectar clínica interior con botes en el exterior, resanado de muros y pintura, de medidas 1.30 x 1.45 x 82 cm.

Podría por favor proporcionarnos una imagen de este mobiliario, ya que así con la sola descripción, es difícil poder cotizarlo.

Se acepta. Se enviara por correo.

PROMOVAGO

1. De acuerdo al punto VIII. Propuesta técnica No. 2 Inciso "A" Menciona que se solicita carta de donde se manifiesta que los equipos son de fabricación nacional.


Se entiende que es una licitación de origen internacional por lo que esta carta solo procede para los equipos con fabricación de origen nacional.

Es correcta esta apreciación?

Es correcta su apreciación.

2. Para la presentación de las propuestas en los diferentes actos de la presente licitación podrá asistir un representante al cual se le otorgue carta poder simple por el representante legal de la compañía.

Se acepta?

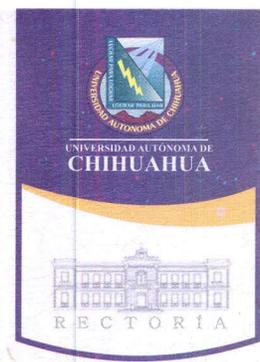

Se acepta su propuesta.

SAPLAI MEDICAL S.A. DE C.V.

1. Punto numero VIII. Inciso A, Numeral 10. Carta que manifieste que la empresa licitante cuenta con un centro de servicio y atención a clientes en la ciudad de Chihuahua, Chih.

Pregunta: se le solicita a la convocante de la manera mas atenta nos permita presentar en esta carta el domicilio de nuestro centro de servicio y atención a clientes ubicado en la ciudad de México, D.F., para no limitar nuestro derecho de libre participación. Se acepta nuestra petición.

Ya fue respondida, se acepta.


De conformidad con el artículo 33 de la Ley, esta Acta forma parte integrante de la Convocatoria.

Para efectos de la notificación y en términos de los artículos 37 Bis de la Ley, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido a este acto, copia de esta Acta en el Departamento de Adquisiciones de la Universidad Autónoma de Chihuahua, en donde se fijará copia de la carátula del Acta o un ejemplar o el aviso del lugar donde se encuentra disponible, por un término no menor a cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal. La información también estará disponible en la dirección electrónica: www.compranet.go.mx

Finalmente, se recuerda que el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo el día 23 de Noviembre de 2015, en la Sala de Juntas del Comité de Adquisiciones, ubicado en calle Séptima, número 1210, Segundo Piso, Col. Centro, a las 11:00 horas, siendo un acto formal que dará inicio puntualmente, por lo que después de esa hora no se permitirá el acceso a ningún licitante ni observador social, de conformidad con el artículo 39 del Reglamento de la Ley.

Después de dar lectura a la presente Acta, se consultó a los licitantes si las respuestas a sus cuestionamiento fueron otorgadas con claridad y precisión, quienes respondieron afirmativamente y manifestaron no tener más dudas o cuestionamientos que hacer a la Convocatoria, así como ninguna objeción respecto de este acto, por lo que se dio por terminada esta primera y última junta, siendo las 11:45 horas, del 10 de Noviembre de 2015.

Esta Acta consta de 11 hojas y 10 hojas de preguntas entregadas por los licitantes, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.

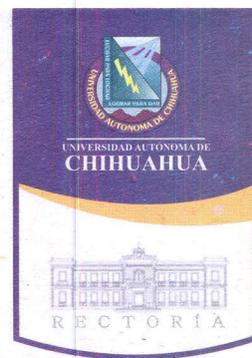

POR LOS LICITANTES:

Nombre, Razón o Denominación Social	Representante y Correo Electrónico	Firma
PROMOVAGO SA DE CV	Abigail Pasillas Tl. Jorgeo@promovago.com	
IVG COMERCIALIZADORA SA DE CV	MARIA GUADALUPE DIAZ RODRIGUEZ mdiaz@ivg.com	
ADESA DENTAL	Silvia Margarita Zubiate Clo edgar.m@adesa.mx	

DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA:

Presidente del Comité de Adquisiciones

Secretario del Comité de Adquisiciones

Director Administrativo

L.A.E. Alberto Farres Chávez
Jefe de Adquisiciones

VOCAL

VOCAL

C.P. Omar Almela Sinecio
Auditor Interno


Lic. Diana Valdez Luna
Abogada General

VOCAL

VOCAL

C.P. Jesús Ubaldó Casillas García
Jefe de Tesorería

L.A.E. Aldo E. Arizmendi Armendáriz
Jefe de Bienes Patrimoniales

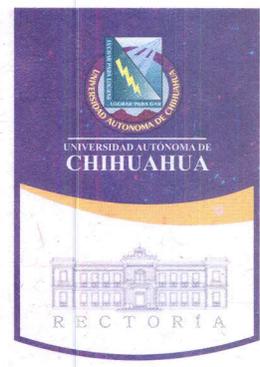

VOCAL

VOCAL

PA

M.A.R.H. Norma Cecilia González Martínez

Lic. Enrique Gallardo García
Patronato

M.A.R.H. Norma Cecilia González Martínez
Jefa del Depto. de Contabilidad

VOCAL

VOCAL

L.E.I. Edel Omar Montoya Maldonado
Jefe del Depto. de Gestoría y Fortalecimientos
Institucional

Dr. Gustavo Blázquez
Representante de la Facultad de
Odontología

POR LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

C.

POR LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

----- FIN DEL ACTA -----



m

FAAR
cy
EVQ
MO

X

FORMATO DE ACLARACION A LA CONVOCATORIA

Licitación: **LA-908047994-T41-2015**
23 de Noviembre de 2015

Universidad Autónoma de Chihuahua
At'n: Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y
Contratación de Servicios:
Presente.-

POR MEDIO DE LA PRESENTE, NOS PERMITIMOS SOLICITAR A LA CONVOCANTE, LA ACLARACIÓN DE LAS SIGUIENTES DUDAS:

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>PUNTO NUMERO VIII, INCISO A, NUMERAL 10.- "Carta que manifieste que la empresa licitante cuenta con un centro de servicio y atención a clientes en la Ciudad de Chihuahua, Chih"</p> <p>PREGUNTA: SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA PRESENTAR EN ESTA CARTA EL DOMICILIO DE NUESTRO CENTRO DE SERVICIO Y ATENCION A CLIENTES UBICADO EN LA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, PARA NO LIMITAR NUESTRO DERECHO DE LIBRE PARTICIPACION. SE ACEPTA NUESTRA PETICION?</p>	
PREGUNTAS	RESPUESTAS
PREGUNTAS	RESPUESTAS

ATENTAMENTE
RICARDO BARRIOS GRANADOS

 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

REPRESENTANTE LEGAL

 CARGO EN EL PROVEEDOR

 FIRMA

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right side and initials 'FAD' at the bottom right.]

Universidad Autónoma de Chihuahua
 Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios,
Convocatoria a la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados
No LA-908047994-T41-2015
 para la contratación de "Adquisición de Equipamiento de Clínicas Dentales"
 solicitados por la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Chihuahua



**PREGUNTAS
 JUNTA DE ACLARACIONES**

Licitación: **LA-908047994-T41-2015**
 6 de Noviembre de 2015

Universidad Autónoma de Chihuahua
At'n: Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y
Contratación de Servicios:
Presente

Preguntas de carácter técnico		
Pregunta No. 1	Partida 2: Solicitan Mesas de Trabajo: Fabricadas en Acero Inoxidable Haysi 430 DE 20" X 20" X 32"H, cuenta con 2 cubiertas en lámina cal. 20 de 1.25" de lado, patas ángulo de acero inoxidable cal. 14, la cubierta superior y 2 entrepaños en forma de charola con bordes de 2" por 3 lados, ruedas sanitarias de 2".	¿ Podemos ofertar las mesas fabricadas en Acero Inoxidable tipo AISI 304 2B, que es de mejor calidad, así mismo que nos proporcionen imágenes de esta mesa.
Pregunta No. 2	Partida 9: Mobiliario con las siguientes especificaciones: A base de estructura metálica de PTC y lámina para almacenar 2 botes de residuos peligrosos para ruta de RPBI de las clínicas dentales, incluye 2 puertas metálicas con pasador y portacandados, bisagras, elaboración de boquete para conectar clínica interior con botes en el exterior, resanando de muros y pintura, de medidas 1.30 x 1.45 x 82 cm	Podría por favor proporcionarnos una imagen de este mobiliario, ya que así con la sola descripción, es difícil poder cotizarlo.

ATENTAMENTE

ALBERTO GONZALEZ TORRES
REPRESENTANTE LEGAL

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several initials below it.]



LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
FACULTAD DE ODONTOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA,
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA
DE TRATADOS NO LA-908047994-T41-2015,
“ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE CLINICAS DENTALES”



LICITACIÓN: LA-908047994-T41-2015
10 DE NOVIEMBRE DE 2015

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CALLE SÉPTIMA 1210
COL. CENTRO
AT'N: COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS:

JUAN ANTONIO SORIA YÁÑEZ, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA JASS DE COMPRESORES S.A. DE C.V. ME PERMITO INDICAR LAS DUDAS QUE TENEMOS CON RESPECTO AL PROCEDIMIENTO LICITATORIO LA-908047994-T41-2015, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE CLINICAS DENTALES.

FORMATO DE ACLARACIÓN

NO.	PREGUNTAS (ESPECIFICAR NUMERAL O PUNTO DE LA INVITACION)	RESPUESTAS
1/1	<p>PUNTO 10 DEL APARTADO VIII. PUNTO 1. INTEGRACION DEL SOBRE QUE CONTIENE LA PROPOSICION: INCISO A PROPOSICION TÉCNICA.</p> <p>1. Carta que manifieste que la empresa licitante cuenta con un centro de servicio y atención a clientes en la Ciudad de Chihuahua, Chih., indicando los datos de las oficinas y atención a clientes de la empresa; así como indicando dirección, horario, teléfono, correo electrónico, y en caso de tener número 01-800, también incluirlo. (Anexo “I”, incluido en éstas bases). En caso de que el convenio de pago directo sea con un proveedor externo; también incluir los datos del mismo.</p> <p>PREGUNTA: TRATANDOSE DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS; ¿ES VALIDO Y OBLIGATORIO TENER EL CENTRO DE SERVICIO Y ATENCION A CLIENTES EN LA CIUDAD? SI ESTE</p>	

FAD




<p>FUERA EL CASO, SE ESTARIA COARTANDO LA LIBRE PARTICIPACION DE POSIBLES PROVEEDORES Y/O FABRICANTES QUE CUENTAN CON EL RESPALDO Y LA CALIDAD DE LOS BIENES A SUMINISTRAR PUESTO QUE SE TRATA DE EQUIPOS NUEVOS QUE ESTAN PRESENTES EN DIVERSAS ENTIDADES TANTO PUBLICAS COMO PRIVADAS EN DIVERSAS CIUDADES DEL PAÍS, SIENDO GARANTIZADAS POR PERIODOS MAYORES AL SOLICITADO EN ESTE CASO POR LA UNIVERSIDAD. FAVOR DE ACLARAR SI ES POSIBLE PARTICIPAR, YA QUE NUESTRO UNICO INTERES ES LA PARTIDA 3.</p>	
---	--

ATENTAMENTE



JUAN ANTONIO SORIA YAÑEZ
REPRESENTANTE LEGAL

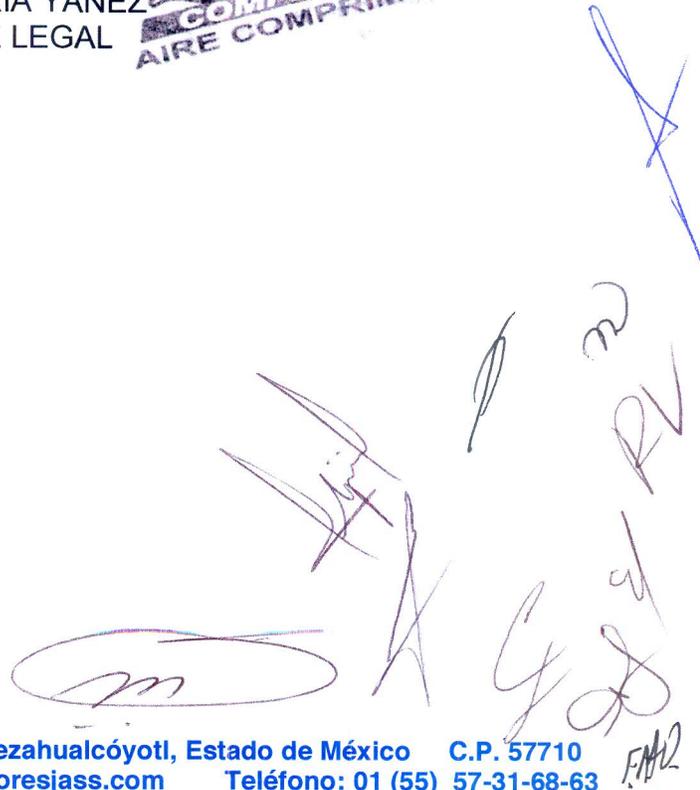



México, D.F. a 6 de Noviembre de 2015.

SOLICITUD DE ACLARACIONES DE DUDAS A LA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN.
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS NO.
LA908047994-T41-2015

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA.
PRESENTE

NOMBRE DEL LICITANTE: PROMEDENTAL S.A. de C.V.
NOMBRE DEL REPRESENTANTE: JOAQUÍN REYES SÁNCHEZ.

POR MEDIO DE LA PRESENTE, NOS PERMITIMOS SOLICITAR, LA ACLARACIÓN A LOS ASPECTOS CONTENIDOS EN LA CONVOCATORIA DEL CITADO PROCESO LICITATORIO.

1.- REFERENCIA 9.10.

SE PIDE A LA CONVOCANTE, FAVOR DE ACLARAR SI PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO EN ESTE PUNTO BASTARA CON PRESENTAR CARTA DE COMPROMISO PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CONTENIENDO LA INFORMACION DEL CENTRO DE ATENCION, CON LOS CONTACTOS, TELEFONOS, HORARIOS Y TIEMPOS DE RESPUESTA, PARA ESTOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO. DEBIDO A QUE EL DOMICILIO FISCAL DE MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA EN LA CIUDAD DE MEXICO, Y AHÍ SE ENCUENTRA TAMBIÉN NUESTRO CENTRO DE SERVICIO EL CUAL TIENE LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN A NIVEL NACIONAL.

2.- REFERENCIA VIII. INTEGRACION DEL SOBRE QUE CONTIENE PROPOSICION.

A) PROPOSICION TECNICA.

SE RECOMIENDA A LA CONVOCANTE, QUE PARA DAR MAYOR VERACIDAD AL PROCEDIMIENTO SE SOLICITE CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE Y/ O DEL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO EN EL PAÍS. DE LOS BIENES OFERTADOS.

3.- REFERENCIA VIII. INTEGRACION DEL SOBRE QUE CONTIENE PROPOSICION.

A) PROPOSICION TECNICA.

SE RECOMIENDA A LA CONVOCANTE, QUE PARA DAR MAYOR CERTEZA JURIDICA Y NORMATIVA, SE SOLICITE A LOS LICITANTES, EL REGISTRO SANITARIO, CERTIFICADOS DE BUENAS PRACTICAS DE FABRICACION, EMITIDO POR LA COFEPRIS, ISO 9001-2008 Y/O, ISO 13485, CE Y/O FDA O TUV, SEGÚN CORRESPONDA PARA BIENES NACIONALES O INTERNACIONALES.

TODO ESTO PARA EVITAR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE DUDOSA CALIDAD, COMO LOS DE PAISES TALES COMO CHINA, PAKISTAN, COREA, MALASIA Y TAIWAN, QUE PONEN EN RIESGO LA INTEGRIDAD DEL PACIENTE.

CABE MENCIONAR QUE A LA FECHA, NO EXISTEN EQUIPOS NACIONALES QUE CUMPLAN CON LAS NORMAS MINIMAS DE CALIDAD Y LEGISLACION SANITARIA.



**4.- REFERENCIA VIII. INTEGRACION DEL SOBRE QUE CONTIENE PROPOSICION.
A) PROPOSICION TECNICA.**

FAVOR DE ESPECIFICAR EL TIEMPO DE GARANTIA DE BIENES QUE REQUIERE LA CONVOCANTE. CONSIDERANDO VIABLE UN PERIODO DE 12 MESES.

**5.- REFERENCIA VIII. INTEGRACION DEL SOBRE QUE CONTIENE PROPOSICION.
A) PROPOSICION TECNICA.**

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARE DE QUE EN CASO QUE LOS BIENES OFERTADOS REQUIERAN INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA SI LAS INSTALACIONES DE LA CONVOCANTE YA CUENTAN CON LAS ADECUACIONES ELECTRICAS, AIRE E HIDROSANITARIAS EN LOS LUGARES DE DESTINO FINAL.

**6.- REFERENCIA VIII. INTEGRACION DEL SOBRE QUE CONTIENE PROPOSICION.
A) PROPOSICION TECNICA.**

EN CASO DE QUE SU RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, FAVOR DE INDICAR SI BASTARA EN CASO DE SER ADJUDICADO, QUE ENTREGUEMOS LA GUÍA MECÁNICA CORRESPONDIENTE A LOS EQUIPOS QUE NECESITEN INSTALACIÓN, PARA QUE LA CONVOCANTE ADECUÉ LAS ÁREAS DE DESTINO FINAL, YA QUE NUESTRO SERVICIO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA NO COMPRENDE LAS OBRAS CIVILES EN LAS UNIDADES CLÍNICAS.

**7.- REFERENCIA ANEXO UNO – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES. PARTIDA 1.
FAVOR DE ACLARAR SI SE PODRÁ OFERTAR CON ESCUPIDERA DE PORCELANA. YA QUE ESTA CARACTERISTICA NO AFECTA LA OPERACIÓN Y PROCESOS ODONTOLÓGICOS NI LA INTEGRIDAD DEL PACIENTE.**

**8.- REFERENCIA ANEXO UNO – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES. PARTIDA 1.
FAVOR DE ACARAR SI SE PODRÁ OFERTAR CONTROL DE PIE Y TOUCH PAD.**

**9.- REFERENCIA ANEXO UNO – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES. PARTIDA 1.
FAVOR DE ACLARAR SI SE REFIERE TOUCH PAD, IGUAL A DIGITAL.**

**10.- REFERENCIA ANEXO UNO – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES. PARTIDA 1.
FAVOR DE ACLARAR SI SE PODRÁ OFERTAR CON ACCIONAMIENTO DE LAMPARA, ESCUPIDERA NEGATOSCOPIO, LLENADO DE VASO Y MOVIMIENTOS, DIGITALES SIN PERILLAS, LO CUASL ES UNA TECNOLOGIA SUPERIOR.**

**11.- REFERENCIA ANEXO UNO – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES. PARTIDA 1.
FAVOR DE ACARAR SI EL EQUIPO SE NECESITA CON CALENTADOR DE AGUA.**

**12.- REFERENCIA ANEXO UNO – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES. PARTIDA 1.
FAVOR DE ACLARAR SI EL EQUIPO SE NECESITA CON MEMORIAS PROGRAMABLES PARA LOS MOVIMIENTOS DEL SILLON.**



13.- REFERENCIA ANEXO UNO – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES. PARTIDA 1.
FAVOR DE ACLARAR SI EL EQUIPO SE NECESITA CON 3 ENTRADAS PARA PIEZAS DE MANO Y
UNA PARA JERINGA TRIPLE

Atentamente

Bajo Protesta de Decir Verdad

Joaquín Reyes Sánchez
REPRESENTANTE LEGAL

Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados.
No.LA-908047994-T41-2015
Adquisición de Equipamiento de Clínicas Dentales

PREGUNTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES


DE ACUERDO AL PUNTO VIII PROPUESTA TECNICA No. 2 INCISO "A" MENCIONA QUE SE SOLICITA CARTA DE DONDE SE MANIFIESTA QUE LOS EQUIPOS SON DE FABRICACION NACIONAL.

Se entiende que es una licitación de origen internacional por lo que esta carta solo procede para los equipos con fabricación de origen nacional.

Es correcta esta apreciación.

Para la presentación de las propuestas en los diferentes actos de la presente licitación podrá asistir un representante al cual se le otorgue carta poder simple por el representante legal de la compañía

Se acepta.

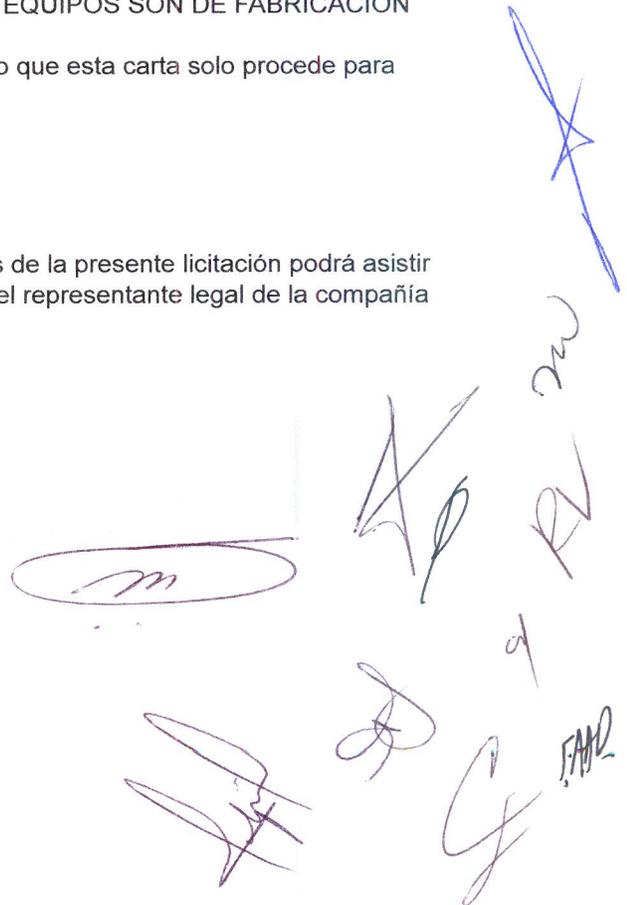

Handwritten signatures in blue and purple ink, including a large blue signature at the top right and several purple signatures below it.



9 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados.
No.LA-908047994-T41-2015
Adquisición de Equipamiento de Clínicas Dentales

PREGUNTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES

DE ACUERDO AL PUNTO VIII No. 2 INCISO "C" SE ENTIENDE SE RECIBIRAN PROPUESTAS DE EQUIPOS QUE CUMPLAN CON LAS REGLAS DE ADQUISICION DE ACUERDO AL TRATADO DE LIBRE COMERCIO.

Es correcta esta apreciación.

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA LOS EQUIPOS DE IMPORTACION PODRIAN AMPLIAR EL TIEMPO DE ENTREGA A 60 DIAS CONTADOS APARTIR DEL FALLO.

Se acepta la propuesta.

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SI NOS PODRIAN INFORMAR SI LA PARTIDA 1 UNIDADES DENTALES SE INSTALARAN EN UNA CLINICA NUEVA O DONDE YA EXISTEN UNIDADES DENTALES.

SUGERIMOS A LA CONVOCANTE QUE LOS EQUIPOS DE IMPORTACION SE ANEXEN REGSITROS DE CALIDAD COMO CE, ISO,FDA Y CERTIFICADO DE ORIGEN DE ACUERDO A LAS NORMAS INTERNACIONALES SIENDO ESTO REQUISITO PARA TODOS LOS PARTICIPANTES .

Se acepta la propuesta.

SUGERIMOS A LA CONVOCANTE SOLICITE CARTA DIRECTA DE FABRICANTE ASI COMO SE PIDA EN ORIGINAL Y NOTARIADA Y/O APOSTILLADA EN ORIGINAL Y QUE SEA UN REQUISITO PARA TODOS LOS PARTICIPANTES.

Se acepta la propuesta.

LAS MESAS DE TRABAJO, PARTIDA 2, SE PUEDE OFERTAR DE TUBO CUADRADO EN VEZ DE REDONDO CON CUADRADO QUEDA MEJOR.

Se acepta la propuesta.

DEL BANCO EL PISTON QUE SOLICITAN EN LA PARTIDA 7, LA BASE METALICA ES DE ACERO COMERCIAL TUBULAR METALICO CROMADO O DE HIERRO FUNDIDO CROMADO O DE ALUMINIO FUNDIDO, YA QUE NUESTRA APRECIACION LA IDENTIFICA COMO TUBULAR CROMADA,

Es correcta nuestra apreciación.?




ATENTAMENTE



MARIA GUADALUPE DIAZ RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL







Handwritten notes and signatures in blue ink:


- Top right: *[Signature]*
- Middle right: *RV*
- Bottom right: *[Signature]*
- Bottom center: *[Signature]*



[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials, including 'JAH2']

SALID
EMERG

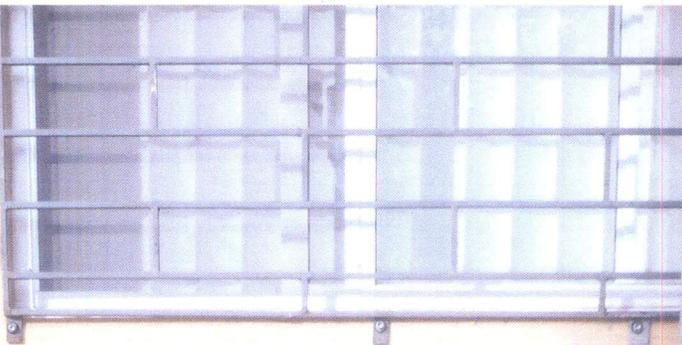

Handwritten signatures and initials on the right wall, including a large signature at the top, a signature below it, and several initials and marks at the bottom.

A large handwritten 'X' mark on the floor.

A circled handwritten signature or initials on the floor.

Handwritten initials or a signature on the floor.

EMERGENCIA

ENTRADA
CLÍNICAS E y F
→



X *m* *X* *FAAD* *CF*



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials, including 'PACD']



X

W

Handwritten notes in blue ink, including a signature and the text "EMR" and "22".



Handwritten markings in blue and black ink on the wall above the cabinet, including a circled signature and various scribbles.

EXCLUSIVAMENTE
RESERVADO PARA EL USO
DE LOS ESTUDIANTES
DEL INSTITUTO VENEZOLANO
DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
Y TECNOLÓGICAS
VENEZUELA

EXCLUSIVAMENTE
RESERVADO PARA EL USO
DE LOS ESTUDIANTES
DEL INSTITUTO VENEZOLANO
DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
Y TECNOLÓGICAS
VENEZUELA

